

①

規格書案

製品名	LS-WOX 日本リボ-Y-u 400	
項目	規格値	検査方法
外観	微黄色半透明	官能試験
粒度分布	中央値: 110~130 μ 90%: 80~220 μ	粒度分布計
混入物など	認めない	官能試験
臭い	弱い特異臭	官能試験
総酸素量	100ppm以上	400 ppm 以上 CH法
pH	5.0~7.0	pH測定器
一般生菌数	100c.f.u./ml以下	一般生菌数測定用培地
比重	1.00~1.10	比重瓶
ヒ素	2ppm以下	
重金属(Agを除く)	10ppm以下	
	以下余白	
・保管条件: 2~8℃冷蔵保管、直射日光に当たる、高温になる場所を避けること。 容器のまま凍らせたりしないこと。 ・品質保証期限: 冷蔵未開封で製造後3年 安定化銀(1ppm添加): 沈殿が生じたときは攪拌してからご使用ください。		


メディサイエンス・エスポア株式会社

制定日 : 2024年9月5日

2025 10月 ?


酸素リポソームエビデンス (皮膚内水分量測定)

酸素リポソーム

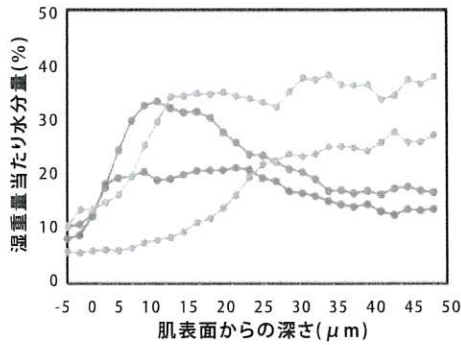

酸素リポソームを塗布した肌では、塗布40分後に水分量が増加する傾向にあった。

RO水

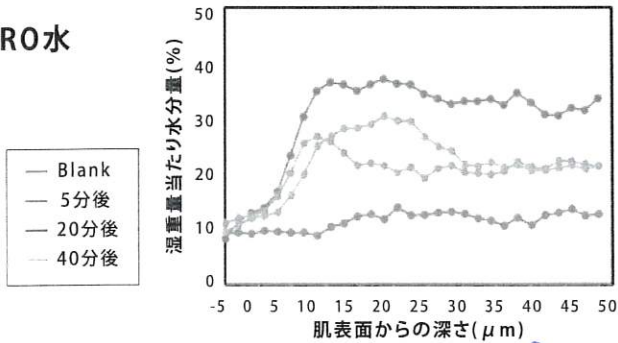

RO水を塗布した肌では、塗布5分後に水分量が増加し、20分後、40分後に低下し、Blankの状態に戻る傾向が見られた。

ラマン分光光度計データ



【酸素リポソーム保管条件】
2~8℃冷蔵保管、直射日光に当たる場所、高温になる場所を避けること。容器のまま凍らせたりしないこと。

【酸素リポソーム使用法】
室温に戻し、攪拌して使用ください。
沈殿が生じた時も攪拌してからご使用ください。

酸素リポソーム規格

酸素包接水和物配合

項目	規格値	検査方法
外観	微黄色半透明	官能試験
粒度分布	中央値:110~130 μ 90%:80~220 μ	粒度分布計
混入物など	認めない	官能試験
臭い	弱い特異臭	官能試験
総酸素量	100ppm以上	CH法
pH	5.0~7.0	pH測定器
一般生菌数	100c.f.u./ml以下	一般生菌数測定用培地
比重	1.00~1.10	比重瓶
ヒ素	2ppm以下	
重金属(Agを除く)	10ppm以下	

酸素リポソーム成分

水、グリセリン、水添レシチン、ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ダイズタンパク、水添レシチン、酸素、銀



処方リスト

1. 酸素リポソームシャンプー
2. 酸素リポソームヘアトリートメントクリーム
3. 酸素リポソーム育毛剤
4. 酸素リポソーム洗顔料
5. 酸素リポソームクリーム
6. 酸素リポソームジェル
7. 酸素リポソームローション
8. 酸素リポソーム日焼け止め

※処方例は別紙参照

この成分は不純物？
はい？

